

目次

スレーブデバイスへの指紋登録	1
例	1

システム構成, BioStar 2


スレーブデバイスへの指紋登録

BioStar 2.5.0以降からは、スレーブデバイスでも直接指紋登録ができます。
これは、指紋をスキャンするデバイスとして、スレーブデバイスの選択もできることを意味します。

例

- BioStation A2 (id: 541531003) - マスターデバイス
- BioStation L2 (id: 540084005) - スレーブデバイス

** マスターデバイスは、RS-485ケーブルを通じてスレーブデバイスと接続されます。

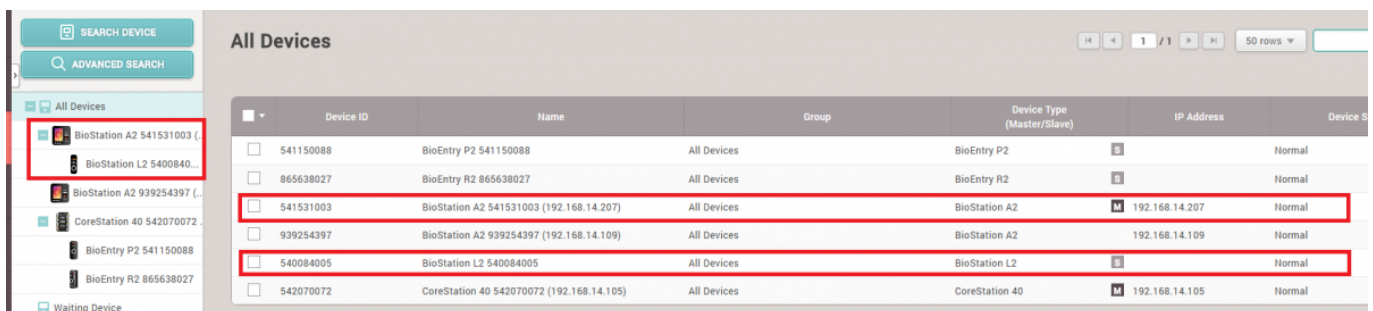

Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device S
<input type="checkbox"/> 541150088	BioEntry P2 541150088	All Devices	BioEntry P2	192.168.14.105	Normal
<input type="checkbox"/> 865638027	BioEntry R2 865638027	All Devices	BioEntry R2	192.168.14.105	Normal
<input type="checkbox"/> 541531003	BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)	All Devices	BioStation A2	192.168.14.207	Normal
<input type="checkbox"/> 939254397	BioStation A2 939254397 (192.168.14.109)	All Devices	BioStation A2	192.168.14.109	Normal
<input type="checkbox"/> 540084005	BioStation L2 540084005	All Devices	BioStation L2	192.168.14.105	Normal
<input type="checkbox"/> 542070072	CoreStation 40 542070072 (192.168.14.105)	All Devices	CoreStation 40	192.168.14.105	Normal

スレーブデバイスを選択した後、指紋をスキャンすると、指紋登録が完了します。

Enroll Fingerprint


• Device: **BioStation L2 540084005**

• Quality: 80

View Image

Enroll Fingerprint

1st
2nd
+ Add

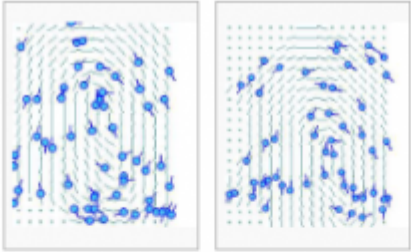

Scan
Delete
Validate
 Duress

Enroll Cancel

- Entry v2デバイス(BLN、BEW、BEP)がマスターデバイスである場合、該当機能はBioStar 2.5.0でサポートされません。該当機能は、以降のバージョンでサポートされる予定です。
- Entry v2デバイス(BLN、BEW、BEP)がスレーブデバイスである場合、該当機能はBioStar 2.5.0でサポートされます。この場合、スレーブデバイスを該当機能を支援するファームウェアバージョンにアップグレードしなければなりません。

From: <http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link: http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ja:fingerprint_enrollment_on_the_slave_device&rev=1566527965

Last update: 2019/08/23 11:39